


# 实验室电子信息牌信息维护操作手册


1. 登录系统。建议使用谷歌、edge 浏览器，  
<https://hse.ecnu.edu.cn/lsms/login>，输入本人公共数据库账号、密码登录或者登录学校公告数据库，按下图所示路径找到简称为“安全助理”的图标进入



2. 进入助理系统依次找到“基础信息管理-实验室用房（电子看板）”，选中要修改的房间，点击“修改”按钮。

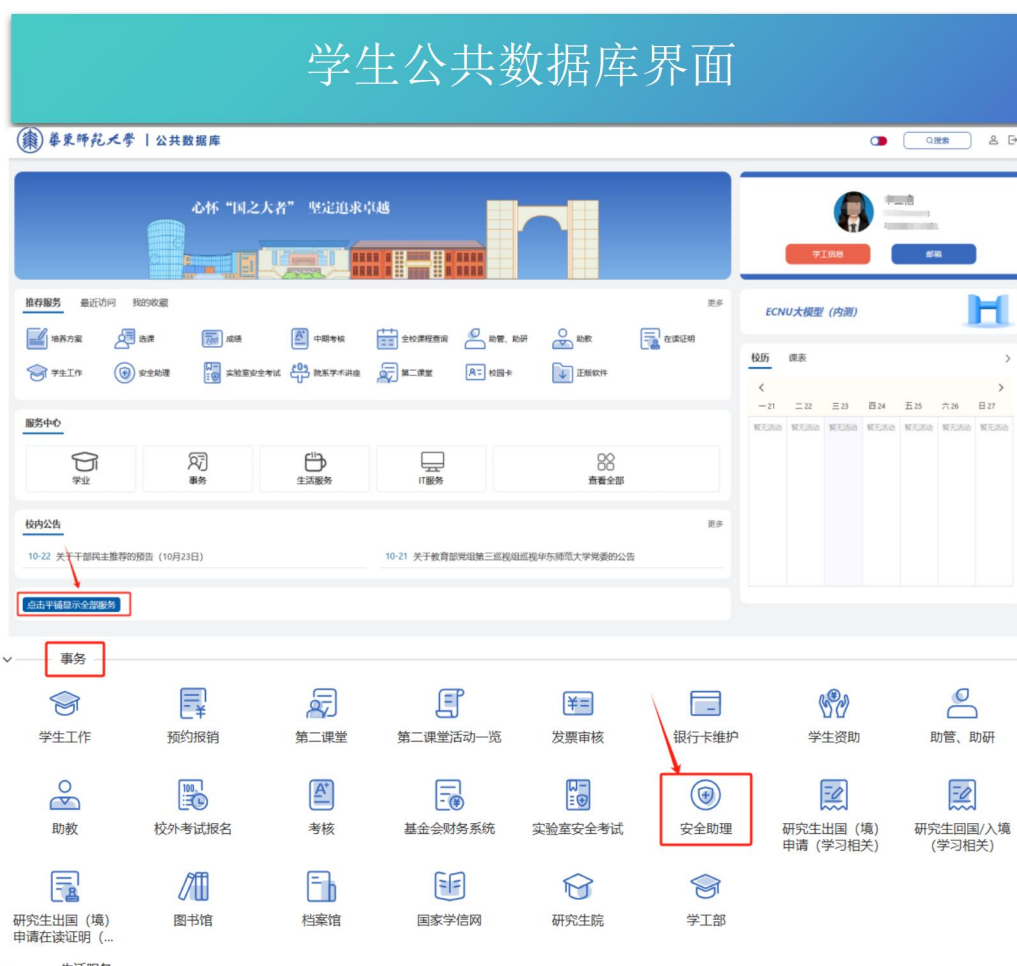

3. “化学品”“气体钢瓶”“仪器设备”三类危险源信息根据实验室是否涉及进行选择，（注意：目前仪器设备页面只可展示激光设备，如没有可以不选择，否则页面无内容）“安全信息牌”和“实验室简介”是默认页面，无须勾选。

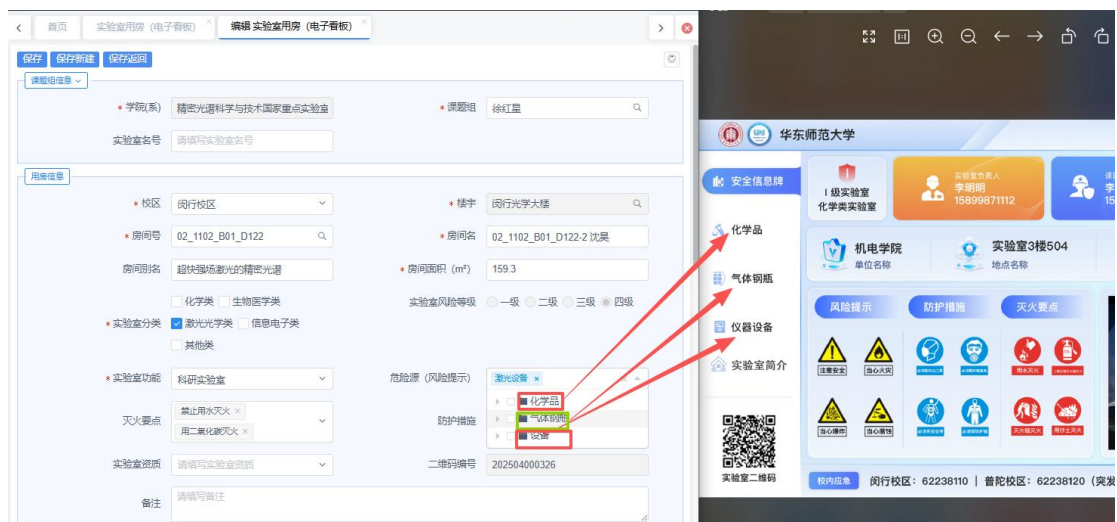

安全助理系统页面（左）电子看板页面（右）（下同）

勾选后各页面展示如下图所示：





“化学品”和“气体钢瓶”页面数据来自于实验耗材采购管理平台和实验室安全助理系统日常贴码入库数据，无需维护。

4. 如涉及“化学品”“气体钢瓶”“仪器设备”其中任何一类危险源请点击前面“△”展开按钮进一步明确内容，系统会将该信息转化为风险提示图标（5、6步逻辑相同），展示在“风险提示”列，如下图所示。



5. 根据实验室危险源情况选择合适的灭火方式。实验室内存有精密设备建议选择二氧化碳灭火器灭火；存有遇水易燃化学品请选择“禁止用水灭火”，**灭火要点是紧急救援情况下的关键信息，请认真勾选！**



6. 根据实验室开展的实验使用的危险源情况选择必要的防护方式（注意：激光器的在另外的页面维护）。



7. 在实验室简介部分可对实验室的研究方向做简要介绍，目前实验室简介仅支持文字编辑，后续将增加图片插入和文件上传等功能，敬请关注！

